


**Наименование исследования:** Ультразвуковое исследование печени на аппарате Фиброскан.

**Эластичность печени** 12,8 кПа **Стадия фиброза** F3 по шкале Metavir

**Стеатоз** 242 dB/m **Степень стеатоза** S2

**ВРАЧ** [подпись] **Подпись**

**FibroScan**

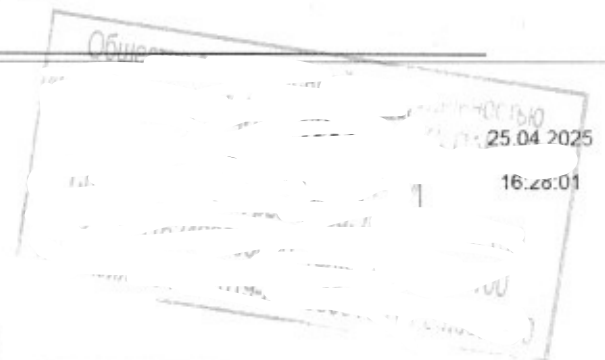

Алексей павлович  
15.11.1972 (М)

IQR  
25

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕН

242

E (kPa)

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕН

12.8

IQR

0.9


IQR/cp  
7%

Исследование M (Печень)

Оператор :

Учитываемые измерения : 12

Всего измерений : 12

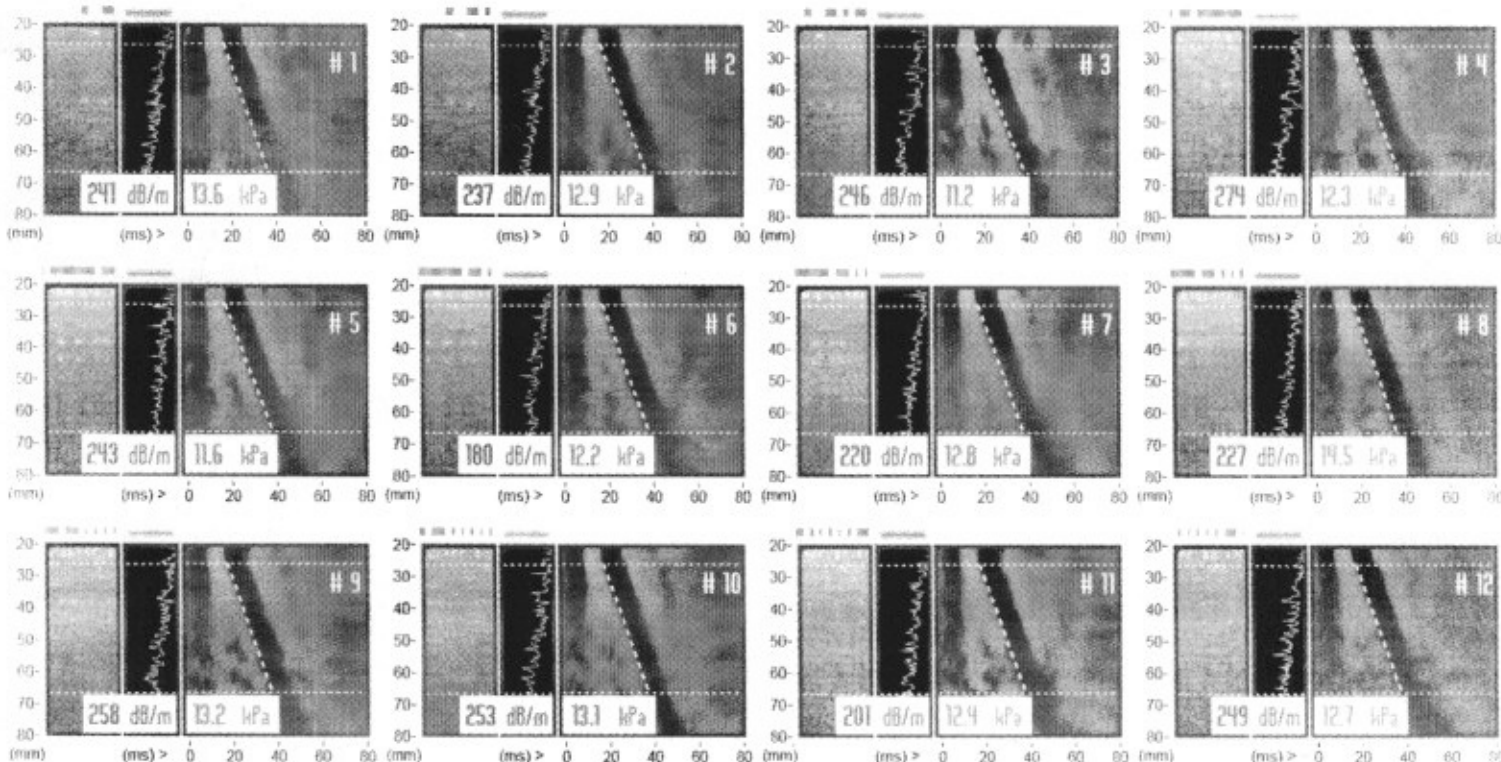

Примечания :

FibroScan 502 Touch (SN:F62019) - Probe M (SN:71705) - C3.1

FibroScan® – это медицинский аппарат для оказания помощи пациентам с хроническими заболеваниями печени. Измерения должны проводиться сертифицированным оператором. Полученные показания должны оцениваться врачом-гепатологом, с учетом истории болезни пациента, количества достоверных измерений и их дисперсии. Датчики необходимо калибровать согласно рекомендациям производителя.

**echosens**

**Внимание!!! При обострении (повышение АЛТ и АСТ более 3-5 норм) результат эластографии может быть завышен.**

Фиброз		Стеатоз		S1	S2	S3
F0	5,8 кПа и меньше	положительный результат, говорящий об отсутствии фиброза печени	Здоровые люди	234 - 268	269 - 300	От 301
F1	5,9 - 7,2 кПа	начальная стадия фиброза	НЖБП	234 - 268	269 - 300	От 301
F2	7,3 - 9,5 кПа	умеренные проявления фиброза	Хронический гепатит В	222-246	247 - 273	От 274
F3	9,6 - 13 кПа	существенные проявления фиброза	Хронический гепатит С	222 - 232	233 - 289	От 290
F4	Более 13кПа	выраженные проявления фиброза	Алкогольный гепатит	248 -267	268 - 279	От 280
			Первичный билиарный цирроз	248 -267	268 - 279	От 280