

Отчёт об обследовании

УЧРЕЖДЕНИЕ

GBUZ SKIB
Mltrofana Sedina 204
Krasnodar

ПАЦИЕНТ

Фамилия ~~Иванов~~

Дата рождения 1954-06-06

Имя IGOR

Пол Муж

Код

Врач

ОБСЛЕДОВАНИЕ

Дата и время 2016-06-28 13:02:45

Обследование XL (Liver)

Оператор ARAPOV

Количество достоверных показателей 11

Прибор Fibroscan 502 F01639

Количество недостоверных показателей 3

Датчик 90600

Показатель эффективности 79%


E (kPa)

Медиана 15.1

IQR* 0.7

IQR/медианы 5 %

*IQR: интерквартильный размах

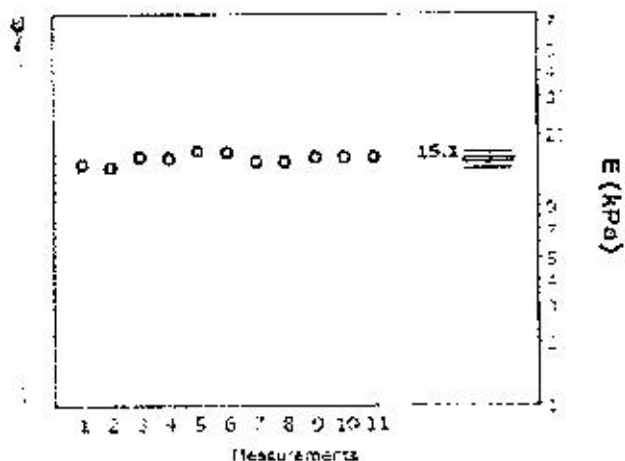

Комментарий

F4

С целью поддержки рабочих характеристик прибора, датчик должен калиброваться каждые шесть месяцев. FibroScan® является медицинским диагностическим прибором. Обследование должно проводиться сертифицированным оператором. Результат должен объясняться практикующим врачом, который является специалистом по печёночным заболеваниям, в соответствии с клинической ситуацией заболевания и принимая во внимание количество действительных показателей, их разброс (IQR) и показатель эффективности: www.fibroscan.com

2016-06-28T13:06:22

Отчёт сформирован FibroScan

Страница 1/1